

INGAL
COSMETICS

(ingal)

REPART[®] Ġ

линия филлеров
для интимной
контурной
пластики



ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ИНТИМНЫХ ФИЛЛЕРОВ

REPART®
G

линия филлеров для интимной контурной пластики

на основе гиалуроновой кислоты, сшитой безопасным сшивающим агентом – полиэтиленгликоль диглицидиловым эфиром (PEGDE).



Уникальная разработка научно-производственного комплекса INGAL



Соответствует стандартам GMP




Имеют высокий профиль безопасности (не содержат BDDE)



Зарегистрированы на территории РФ

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики "Repart® G" по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020



УДОБНЫ В РАБОТЕ

- Обладают улучшенными вязко-эластичными свойствами по сравнению с филлерами ГК, сшитой BDDE
- Имеют высокую подъемную силу и отличные формообразующие свойства
- Имеют широкий спектр зарегистрированных эстетических и терапевтических показаний
- Удобная дозировка: 1,0 мл; 2,0 мл в шприце



Зарегистрированы на
территории РФ

Имплантат мягких тканей для
интимной контурной пластики
"Repart® G" по ТУ 32.50.22-017-
29155953-2020

О продукте

Repart® Ġ – линия имплантатов мягких тканей для интимной контурной пластики, разработанная на основе инновационной технологии научно-производственного комплекса INGAL.

Гиалуроновая кислота в филлерах сшита с помощью безопасного агента — полиэтиленгликоль диглицидилового эфира (PEGDE). В отличие от препаратов на основе BDDE, PEGDE не токсичен, поэтому Repart® Ġ полностью безопасен для здоровья.

Филлеры Repart® Ġ позволяют улучшить внешний вид и чувствительность интимных зон, повысить качество половой жизни и избавиться от ряда функциональных проблем как у женщин, так и у мужчин. И все это без хирургического вмешательства.

Филлеры представлены в исполнении Repart G Normal с низким модулем вязкости G” и Repart G Deer со средним модулем вязкости G”. Конкретный препарат выбирается исходя из индивидуальных особенностей организма пациента и его запроса.

Применение и эффект

Спектр применения филлеров Repart® G довольно широк: они могут использоваться в терапевтических, эстетических целях и для улучшения сексуальной жизни. Процедура дает возможность увеличить площадь чувствительных зон у женщин: мантии клитора, U-точки и зоны G. Это позволяет деликатно решить проблемы с интимной жизнью, избавиться от комплексов, подарить женщине новое удовольствие и более глубокие ощущения от близости.

Благодаря улучшенной формуле гиалуроновой кислоты филлеры обеспечивают максимально естественную корректировку контуров мягких тканей. Это помогает решить такие эстетические проблемы, как асимметрия половых губ, провисание тканей, зияние половой щели и ряд других.

Незаметный и деликатный, гидрогель равномерно распределяется, сохраняя нужную форму и объем в течение всего периода нахождения в мягких тканях. Филлеры Repart® G дают устойчивый пролонгированный эффект, а процедура введения предельно комфортна для пациента.

Технология

Repart® Ġ разработан на основе уникальных технологий научно-производственного комплекса INGAL:

- технология производства гиалуроновой кислоты SPIDER THREAD

Благодаря инновационной технологии и строгому контролю качества Repart® Ġ отличается улучшенными свойствами. Так, филлеры Repart® Ġ более пластичные и эластичные, чем препараты на основе BBDE. В совокупности с гомогенной текстурой это обеспечивает абсолютный комфорт при введении как для специалиста, так и для пациента.

Полимерная структура филлеров менее жесткая, а эфирные связи более устойчивы. Однородная волокнистая структура по типу «паутины» делает гель более упругим и эластичным.

Гель не фрагментируется на частицы, благодаря чему эффект от процедуры сохраняется максимально долго. А отсутствие BBDE в составе делает Repart® Ġ полностью безопасным для здоровья.

Филлеры Repart® Ġ созданы в соответствии со стандартами GMP профессионалами передовой российской компании в области разработки медицинских изделий. Поэтому специалисты и пациенты могут быть полностью уверены в эффективности и безопасности препарата.

Особенности состава и клинические эффекты

- Действие препарата основано на увеличении объема мягких тканей за счет гиалуроновой кислоты и сшивающего агента PEGDE
- Отсутствие BDDE: препарат не содержит токсических веществ и абсолютно безопасен для здоровья
- Однородная волокнистая текстура по типу «паутины» обеспечивает улучшенную упругость и эластичность гидрогеля
- Менее жесткая полимерная структура, чем у многих конкурентов
- Гель не фрагментируется на частицы и отличается устойчивыми эфирными связями, гарантируя пролонгированный результат
- Высокая пластичность и равномерное распределение в тканях, что обеспечивает максимально естественный эффект
- Гель не вызывает болезненных ощущений
- Моментальный результат

REPART[®] Ġ NORMAL

СОСТАВ

Натрия гиалуронат – 20 мг/мл

Натрия гиалуронат 1,3 МДА (сшитый*) - 90%

Натрия гиалуронат 3,0 МДА (нативный) - 10%

Концентрация 2,0 %



Филлер для интимной контурной пластики низкой плотности (с низким модулем вязкости Ġ[®]), предназначенный для инъекционного введения в поверхностные слои кожи, подкожной клетчатки, слизистые и подслизистые урогенитальной области у мужчин и женщин.

*Сшивка - PEGDE

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ: 1,0 МЛ; 2,0 МЛ В ПРЕДНАПОЛНЕННЫХ ШПРИЦАХ



REPART[®] G DEEP

СОСТАВ

Натрия гиалуронат – 24 мг/мл

Натрия гиалуронат 1,3 МДА (сшитый*) - 90%

Натрия гиалуронат 3,0 МДА (нативный) – 10%

Концентрация 2,4 %

Филлер для интимной контурной пластики средней плотности (со средним модулем вязкости G[®]), предназначенный для инъекционного введения в подкожные слои и подслизистые уrogenитальной области у мужчин и женщин.

*Сшивка - PEGDE


ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ: 1,0 МЛ; 2,0 МЛ В ПРЕДНАПОЛНЕННЫХ ШПРИЦАХ

Известные связывающие агенты

- 1,4-бутандиолдиглицидиловый эфир (БДДЭ),
- 1, 2, 7, 8-диэпоксиоктан (ДЭО),
- дивинилсульфон (ДВС),
- гексаметилендиамин (ГМДА)
- диглицидиловый эфир полиэтиленгликоля (ПЭГДЭ)

ГК + PEGDE



- Более устойчивые эфирные связи¹
- Полимерная структура гидрогеля менее жесткая¹
- Однородная волокнистая структура по типу «паутины»¹
- Гель более упругий и эластичный
- Гель не фрагментируется на частицы

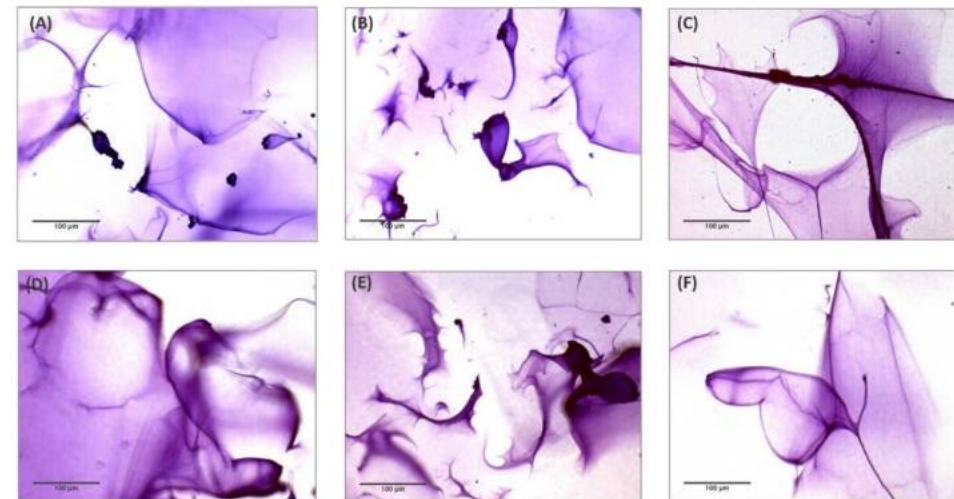

Структура геля ГК, сшитого PEGDE под микроскопом. Увеличение в 10 раз.


ПЭГ и ПЭГДЭ

ПЭГ	ПЭГДЭ
Полимер	Эфир
Крупный размер молекулы от 400 кДа	Малый размер молекулы 250 Да
Пэгилирование	Алкилирование
Эффективная и безопасная система доставки ЛС - слабая сшивка	Система сшивания полимеров – жесткая сшивка

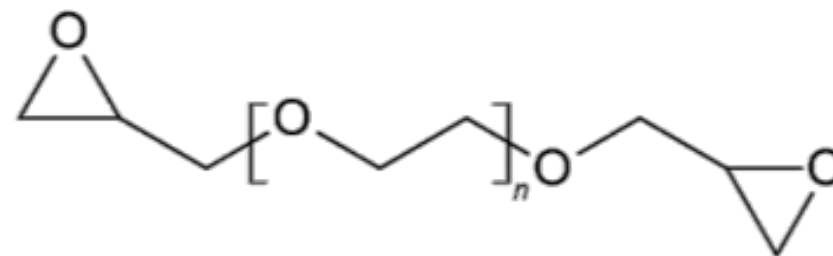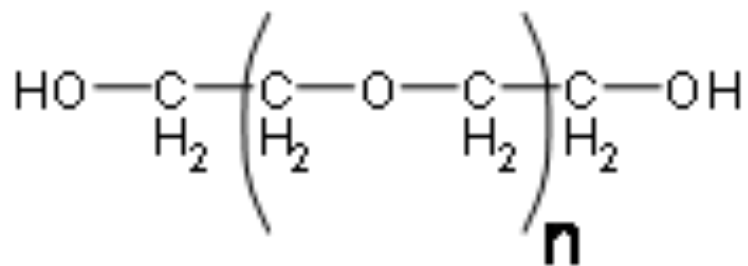

ГК + ПЭГ


ГК + ПЭГДЭ

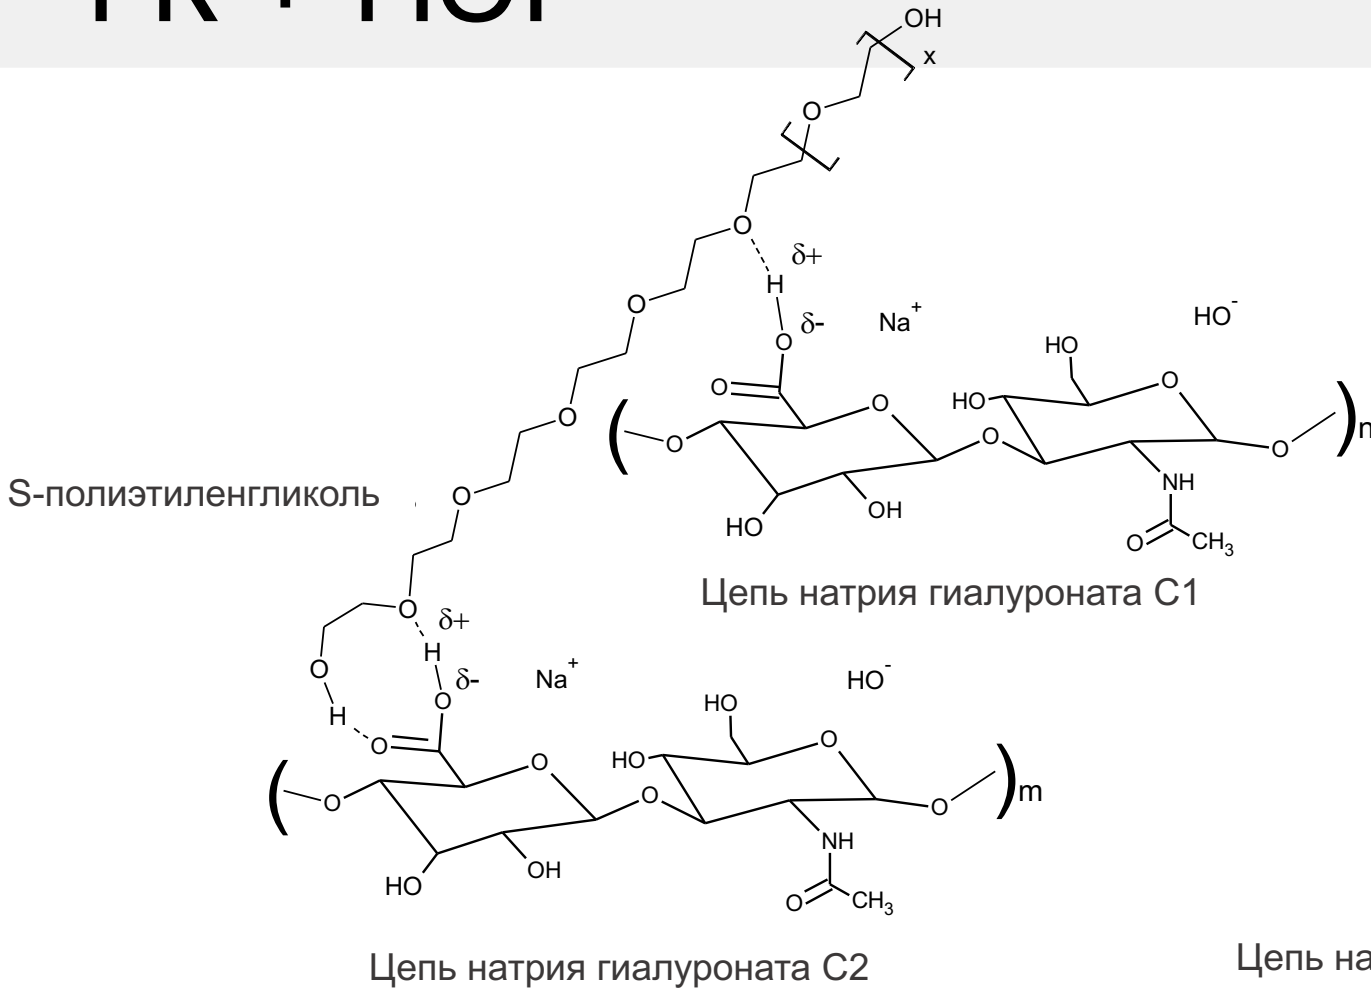

Цепь натрия гиалуроната C1

ПЭГДЭ

Цепь натрия гиалуроната C2

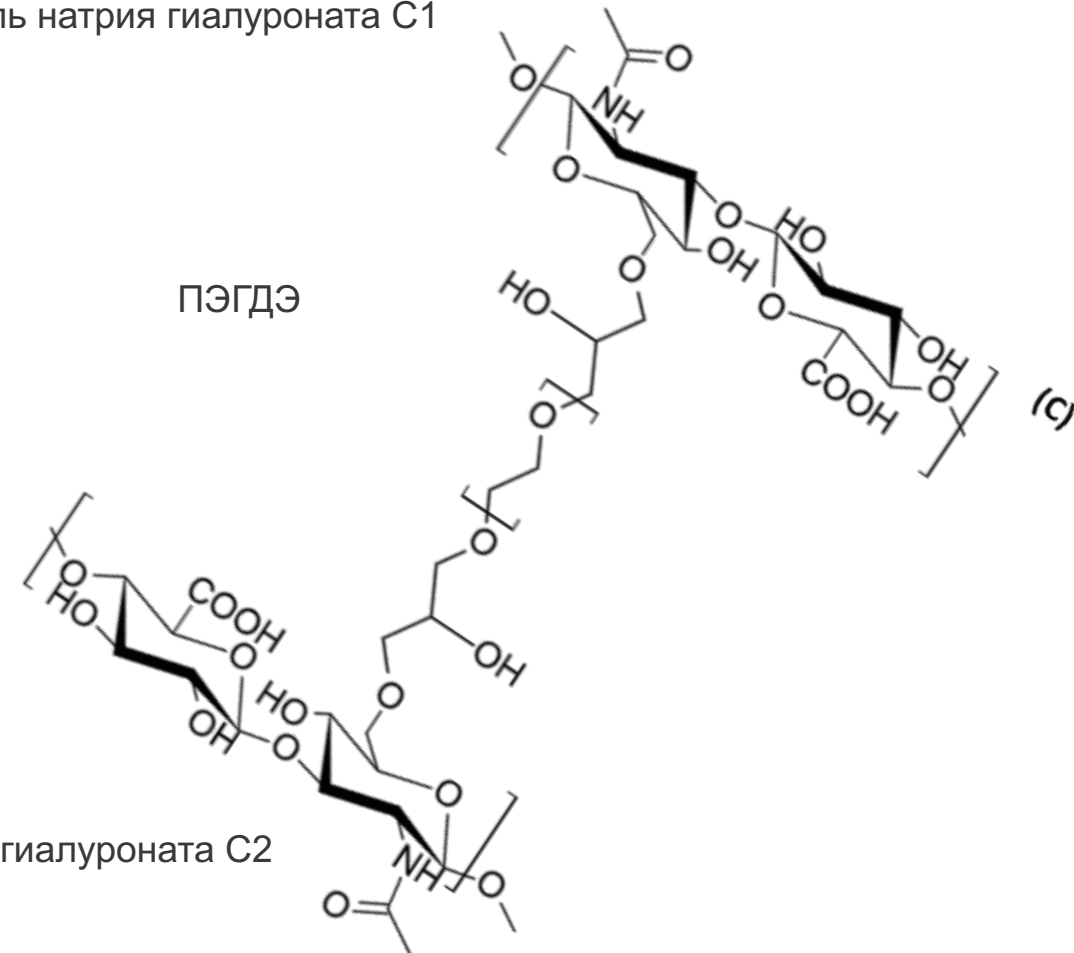

Показания

Терапевтические:

Для женщин.

- Деформация больших и малых половых губ (посттравматические, постоперационные изменения, послеродовые разрывы);
- Дефекты промежности (анатомические, посттравматические, постоперационные, послеродовые, врожденные);
- Коррекция дефектов уретровезикального сегмента при стрессовом недержании мочи у женщин.
- Восполнение объема периуретральной зоны при рецидивирующем посткоитальном цистите у женщин.

Для мужчин.

- Коррекция эстетического дефекта при недержании мочи у мужчин после радикальной простатэктомии или трансуретральной резекции предстательной железы.

Показания

Косметические.

Для женщин:

- Асимметрия половых губ;
- Зияние половой щели вследствие недостаточно выраженных половых губ;

Для мужчин:

- Увеличение головки полового члена.

Показания

Улучшение качества сексуальной жизни.

Для женщин

- Увеличение мантии клитора;
- Увеличение зоны G;
- Увеличение U точки;

Для мужчин

- Увеличение продолжительности эректильной функции у мужчин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ИНЪЕКЦИЯМ ГЕЛЯ-ИМПЛАНТАТА (ФИЛЛЕРА) НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

- Повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия.
- Беременность.
- Период грудного вскармливания.
- Возраст менее 18 лет.
- Острые воспалительные заболевания или проявления хронических кожных заболеваний в зоне предполагаемых инъекций.
- Инфекционные заболевания.
- Наличие онкологических заболеваний или прохождение химиотерапии или лучевой терапии.
- Наличие аутоиммунных заболеваний или прохождение курса аутоиммунной терапии.
- Геморрагический синдром, прием антикоагулянтов и препаратов, снижающих свертываемость крови
- Заболевания урогенитального тракта в острой фазе
- Нарушения опорожнения мочевого пузыря
- Наличие иных имплантатов, в т.ч. постоянных и на основе сшитой гиалуроновой кислоты в зонах предполагаемой коррекции.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:

- Обработанную область нельзя подвергать нагреванию или переохлаждать до тех пор, пока полностью не закончится восстановительный период после инъекции.
- После прохождения процедуры следует строго воздерживаться от половых актов в течение 5-7 дней.
- Рекомендуется исключить употребление алкоголя, посещения бани, сауны, активной физической нагрузки в течение недели после прохождения процедуры.
- Повторять процедуру можно по мере снижения эффекта.
- Спустя 3 недели возможна дополнительная коррекция.
- Исключить применение иных процедур и манипуляций в зоне инъекций без согласования с лечащим врачом

Результаты применения до|после

REPART[®] Ġ

Интимная косметология.

Применение Repart G врачом-косметологом.

REPART[®] Ġ

ВОЗРАСТ ЖЕНЩИН,
ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В
ИНТИМНОЙ ЗОНЕ, ЛЕЖИТ В
ДИАПАЗОНЕ ОТ 25 ДО 60 ЛЕТ.



Законодатель ограничивает сферу деятельности врача косметолога до выполнения манипуляций, связанных с покровными тканями человеческого организма.

Законодатель не ограничивает и не упоминает какую-то конкретную анатомическую область, поэтому врач косметолог имеет право воздействовать на покровные ткани интимной зоны, но с вышеизложенными в приказе целями.

Как и другие виды медицинской деятельности, интимная косметология требует лицензирования.

Приказ Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 № 381н “ Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю “косметология” регулирует вопросы по оказанию медицинской косметологической помощи в организациях государственной формы собственности и частных медицинских организациях.

**ИНТИМНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ РЕШАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:**

- зияние половой щели
- асимметрия или гипоплазия половых губ
- гиперпигментация кожи промежности
- атрофические возрастные изменения кожи
- снижение эластичности, упругости и объема наружных половых органов, связанное с возрастными изменениями
- низкая сексуальная чувствительность
- аномальная форма половых губ, возникшая после хирургических вмешательств, тяжелых родов, травм

REPART G NORMAL и REPART G DEEP могут быть использованы в практики врача-косметолога для решения этих проблем

Конкурентный анализ


REPART[®] Ġ



РОССИЯ



ИЗРАИЛЬ

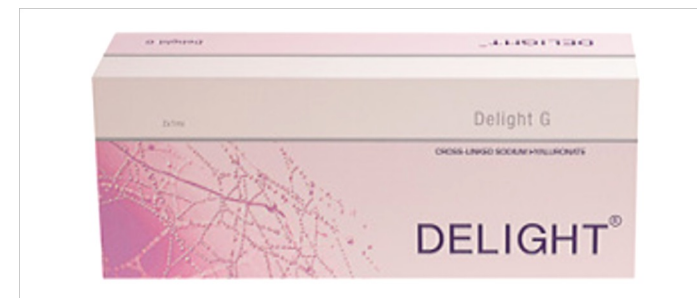

КОРЕЯ



КИТАЙ





Сравниваемый признак	Регистрируемое медицинское изделие	Изделие сравнения										
		Биополимер Гель гиалуроновый стерильный «Амалайн»		Гель-имплантат инъекционный «Delight»		Биополимер гиалуроновый «Риниалл»		EsteFiLL Intim 1\2 ml		HYALUFORM® filler Intimo		
Наименование	Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G» по ТУ 32.50.22-015-017-29155953-2020	Биополимер Гель гиалуроновый стерильный «Амалайн»		Гель-имплантат инъекционный «Delight»		Биополимер гиалуроновый «Риниалл»		EsteFiLL Intim 1\2 ml		HYALUFORM® filler Intimo		
Производитель	ООО «ИНГАЛ», Россия	ООО «МКС – Лаборатория», ООО «СЛС», Россия		Израиль, Adelami Medical Group Ltd.		ООО «СЛС», Россия		ООО "Терлазурра" Россия		MARTINEX Россия		
Регистрационное удостоверение	РЗН 2022/17424 от 1 августа 2022 года	ФСР 2011/11722 от 25 мая 2018		№РЗН 2020/9766 от 19.03.2020 г.		ФСР 2010/09790 от 30 декабря 2010 г		РЗН 2019/8924 по ТУ 32.50.22.190-001-21791916-2016		№ ФСР 2010/06572 от 14.12.2012 г. ТУ 9398-004-58568834-2009		
Форма выпуска (на 1 пачку)	Repart® G Normal Объем: 1 мл, 2 мл Упаковка: 1 или 2 шприца в картонной коробке	- Amalain Intimate Объем 1 мл Упаковка: 1 или 2 шприца в картонной коробке Иглы 27 G, 25 G		Delight G Объем 1 мл Упаковка: 2 шприца в картонной коробке Иглы – 27G		Reneall Secret Life Объем 1 мл Упаковка: 1 шприц в картонной коробке Иглы – 27 G, 25 G		EsteFiLL Intim 1ml Объем 1 мл Упаковка: 1 шприц в картонной коробке Иглы – 27 G, 25 G		HYALUFORM® filler Intimo 1ml Объем 1 мл Упаковка: 1 шприц в картонной коробке		
Форма выпуска (на 1 пачку)	Repart® G Deep Объем 1 мл, 2 мл Упаковка: 1 или 2 шприца в картонной коробке	- Amalain Inconti Объем 2 мл Упаковка: 2 шприца в картонной коробке Иглы 27 G, 25 G				Reneall Pro Active Объем 2 мл Упаковка: 2 шприца в картонной коробке Иглы – 25 G		EsteFiLL Intim 2 ml Объем 2 мл Упаковка: 1 шприц в картонной коробке Иглы – 27 G, 25 G				
Состав	Repart G Normal	20 мг/мл (2%)	Amalain Intimate	20 мг/мл (2%)	Delight	21 мг/мл (2,1%)	Reneall Secret Life	20 мг/мл (2%)	EsteFiLL Intim 1ml	24 мг/мл (2,4%)	HYALUFORM filler Intimo	25 мг/мл (2,5%)
	Repart G Deep	24 мг/мл (2,4%)	Amalain Inconti	20 мг/мл (2%)			Reneall Pro Active	20 мг/мл (2%)	EsteFiLL Intim 2 ml	24 мг/мл (2,4%)		
Сшивающий агент	PEGDE		BDDE		BDDE		BDDE		BDDE		BDDE	



Наименование	Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G» по ТУ 32.50.22-015-017-29155953-2020	Биополимер Гель гиалуроновый стерильный «Амалайн»	Гель-имплантат инъекционный «Delight»	Биополимер гиалуроновый «Риниалл»	EsteFiLL Intim 1\2 ml	HYALUFORM® filler Intimo
Период биодеградации	9 – 12 месяцев	8 – 12 месяцев	От 12 месяцев	Reneall Secret Life – 9-12 месяцев Reneall Pro Active - 24-36 месяцев	7-12 мес. (макс до 18 мес.)	
Срок годности	2 года	18 месяцев	2 года	2 года	nd	nd

<p>Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G» по ТУ 32.50.22-015-017-29155953-2020</p>	<p>Биополимер Гель гиалуроновый стерильный «Амалайн»</p>	<p>Гель-имплантат инъекционный «Delight»</p>
<p>Repart G - линия филлеров для интимной контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты, сшитой безопасным сшивающим агентом – полиэтиленгликоль диглицидиловым эфиром (PEGDE).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обладают улучшенными вязко-эластичными свойствами по сравнению с филлерами ГК, сшитой BDDE - Имеют высокую подъемную силу и отличные формообразующие свойства <p>Структура геля ГК, сшитого PEGDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Более устойчивые эфирные связи¹ • Полимерная структура гидрогеля менее жесткая¹ • Однородная волокнистая структура по типу «паутины»¹ • Гель более упругий и эластичный • Гель не фрагментируется на частицы ПЭГДЭ <ul style="list-style-type: none"> • Не токсичен^{1,2} • Не иммуногенен¹ • Безопаснее в сравнении с БДДЭ² • Хорошо растворим в воде 	<p>Amalain Intimate — монофазный филлер средней плотности на основе гиалуроновой кислоты (20 мг/мл) неживотного происхождения.</p> <p>Встраиваясь в окружающие ткани гиалуроновый гель с течением времени подвергается распаду под воздействием ферментов, но оставляет объем ткани прежним даже в процессе расщепления от 9 до 12 месяцев.</p> <p>Amalain Intimate при введении увеличивает объем выбранного участка, создает дополнительную гидратацию кожи и слизистых оболочек, возвращает эластичность, тонус, способствует процессу естественного обновления. Распространяется в коже и подслизистом слое за счет расслаивания окружающих тканей и интенсивно привлекает к месту своего введения дополнительную межтканевую жидкость.</p> <p>ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОКАЗАНИЙ, REPART G ИМЕЕТ СХОЖИЙ СПЕКТР</p>	<p>В составе интимного филлера DELIGHT® G содержится фосфатный буфер солевого раствора, который позволяет контролировать pH, а также давать эффект ревитализации в момент биодеградации молекулы гиалуроновой кислоты, тем самым увлажняя слизистую оболочку.</p> <p>НЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ФИЛЛЕРАМ</p> <p>ИМЕЕТ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ</p>

Биополимер гиалуроновый «Риниалл»	EsteFiLL Intim 1\2 ml	HYALUFORM® filler Intimo
<p>Reneall Secret Life – бифазный филлер средней плотности на основе 2% (20мг/мл) поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения и в 2 раза сниженной концентрацией BDDE (3% вместо 6%).</p> <p>Reneall ProActive - филлер высокой плотности, получен путем постадийного взаимодействия высокомолекулярной гиалуроновой кислоты эфиром BDDE с образованием надмолекулярной структуры, что обеспечивает длительный терапевтический эффект до 36 месяцев.</p> <p>СЕЙЧАС НЕТ НА РЫНКЕ</p> <p>Бифазный - означает наличие свободной ГК. Аналогичные преимущества есть у REPART G.</p> <p>ДО 36 месяцев – НЕ БЕЗОПАСНО (НЕ ТИПИЧНО ДЛЯ ФИЛЛЕРА. СТАНДАРТНЫЙ СРОК БИОДЕГРАДАЦИИ ДО 18 МЕСЯЦЕВ)</p>	<p>Филлеры с ламеллярной структурой, которые обеспечивают упругость и пластичность.</p> <p>Для производства изделия используется гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота) неживотного происхождения, полученный методом микробной ферментации с молекулярной массой от 1,5 МДа до 3,0 МДа.</p> <p>ТЕХНОЛОГИЯ REPART G гарантирует аналогичные свойства – упругость и пластичность.</p>	<p>Филлер для интимных зон HYALUFORM® Intimo содержит уникальную форму гиалуроновой кислоты высокой степени очистки (фармакопейного класса), получаемой путем бактериальной ферментации, стабилизированной методом твердофазной модификации.</p> <p>Уникальная запатентованная технология cross-modul® обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none">идеальное сочетание пластичности и упругости;эффективное восстановление контуров и объемов мягких тканей интимных зон;абсолютную безопасность – отсутствует свободный BBDE. <p>Научно-исследовательская деятельность по разработке инновационной формулы имплантатов HYALUFORM® filler разработана совместно со швейцарской компанией Suisselle с учетом самых строгих требований, предъявляемые к свойствам, качеству, эффективности и безопасности современных препаратов ISO 13485. Формула защищена международным патентом.</p> <p>MARTINEX</p> <p>Имеет только один вариант исполнения.</p>




Repleri	Sofiderm
<i>НовоНексус (Китай)</i>	<i>Техдерм Корея</i>
НЕ зарегистрирован для интимной контурной пластики (в тч нет информации в инструкции)	РУ №РЗН 2021/14300 В способе применения указано: «для дермального или подслизистого применения»
Repleri №3 Концентрация: 24 мг/мл Размер иглы: 27-26 G Расфасовка: 1 x 1 мл	1/2 ml Sofiderm DERM PLUS 1 ml / 2 ml 10 ml / 20 ml
Repleri №3 24 мг/мл (2,4%) BDDE	Sofiderm FINELINE, DERM,DEEP, DERM PLUS 20 мг/мл (2%) BDDE
ПО ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ (НЕТ ПОКАЗАНИЙ В ИНСТРУКЦИИ) Инъекционная перинеопластика , Увеличение точки G , Инъекционная клиторопластика, Инъекционная лабиопластика 10-12 мес https://repleri.ru/repleri/intimate/	Только для внутрикожного введения (большие и малые половые губы) в инструкции нет показаний. https://techderm.pro/sofidermintim
REPLERI – линейка внутридермальных филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты неживотного происхождения, разработанных для решения эстетических проблем и представляющих собой микроинъекционный материал-гель с разным уровнем вязкости. Главное отличие филлеров Repleri - клинические исследования в России. После регистрации филлеров в 2008 году, ежегодно проводились постклинические исследования, которые показали предсказуемые результаты, удовлетворили запросы пациентов и доказали безопасность филлеров.	Нет
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ДЛЯ ИНТИМНОЙ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ (В ТЧ НЕТ ИНФОРМАЦИИ В ИНСТРУКЦИИ). ДОРОЖЕ, ЧЕМ REPART G	

G NORMAL

Конкурентное окружение (наименование)	Фасовка (шт. в уп./ объем шприца)	Концентрация ГК/ действующего вещества	Страна производитель	Наименование производителя	Базовая цена прайса без скидок	Цена за мл.	Цена за 3 мл.
Repart G Normal (1 мл)	1 шприц/1 мл	20 мг/мл	Россия	ООО "ИНГАЛ"	р.4 100	р.4 100	
Repart G Normal (2 по 1 ml)	2 шприца x 1,0 мл	20 мг/мл	Россия	ООО "ИНГАЛ"	р.6 500	р.3 250	
Repart G Normal (1 по 2 ml)	1 шприц/2 мл	20 мг/мл	Россия	ООО "ИНГАЛ"	р.6 700	р.3 350	р.10 600
Amalain Intimate 1 ml	1 шприц/1 мл	20 мг/мл	Россия	ООО «МКС – Лаборатория», ООО «СЛС»	р.6 500	р.6 500	
Amalain Intimate (2 по 1 ml)	2 шприца x 1,0 мл	20 мг/мл	Россия	ООО «МКС – Лаборатория», ООО «СЛС»	р.12 700	р.6 350	р.19 200
Delight G (3 по 1 ml)	3 шприца x 1,0 мл	21 мг/мл	Израиль	Adelami Medical Group Ltd.	р.14 200	р.4 733	р.14 200
Renell Secret Life 1 ml	1 шприц/1 мл	20 мг/мл	Россия	ООО "СЛС"	р.6 000	р.6 000	р.18 000
EsteFiLL Intim 1 ml	1 шприц/1 мл	24 мг/мл	Россия	ООО "Терлазурра" Россия	р.6 500	р.6 500	р.19 500
Sofiderm 1 ml	1 шприц/1 мл	20 мг/мл	Китай	Техдерм Кмиай	р.3 950	р.3 950	
Sofiderm 1 по 2 ml	1 шприц/2 мл	21 мг/мл	Китай	Техдерм Кмиай	р.5 850	р.2 925	р.9 800

G NORMAL

Цена за мл. REPART G NORMAL

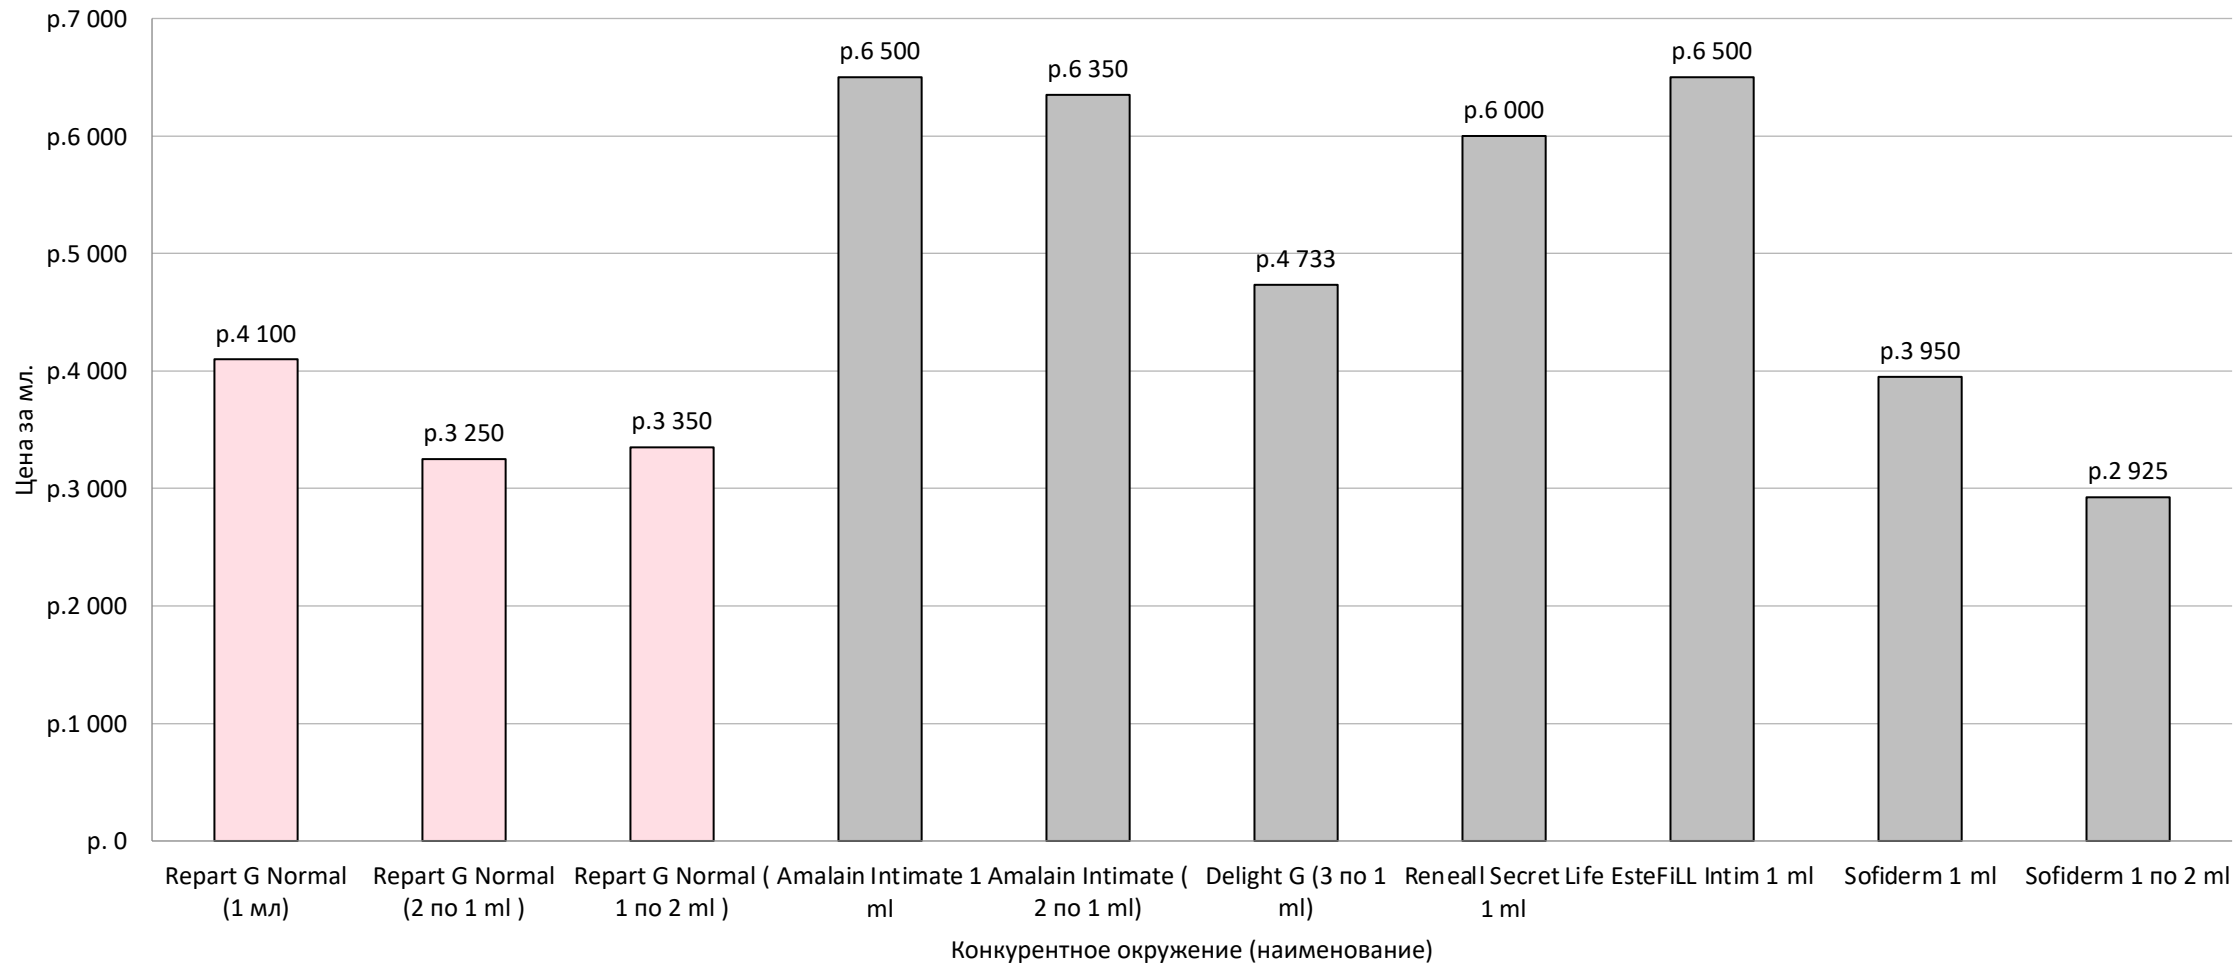


G NORMAL

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ТРЕБУЕТ РАСХОДА ПРЕПАРАТА ОТ 3 ML

Цены за 3 ml рассчитана на основе самой выгодной ценовой комбинации

Цена за 3 мл. относительно параметра "Конкурентное окружение (наименование)"

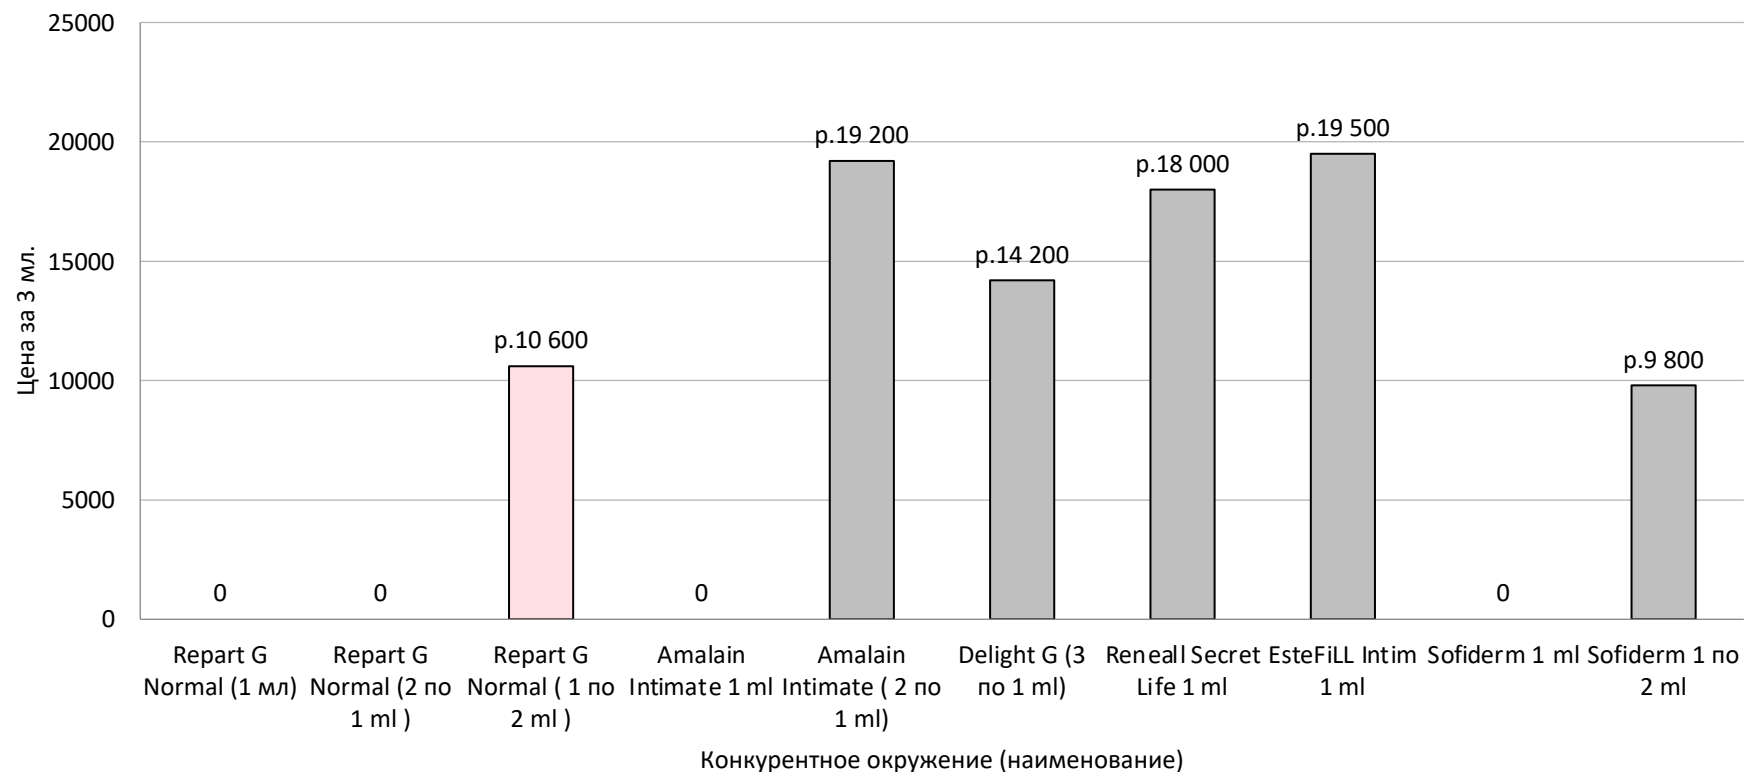

Sofiderm – производство Корея, не известно качество субстанции, нет информации о производстве. Нет подробного описания препаратов на сайте.


Использование филлера для интимной пластики отражено в инструкции ТОЛЬКО для внутрикожного введения (большие и малые половые губы).

G DEEP

Конкурентное окружение (наименование)	Фасовка (шт. в уп./ объем шприца)	концентрация ГК/ действующего вещества	Страна производитель	Наименование производителя	Базовая цена прайса без скидок	Цена за мл.	Цена за 3 мл.	Цена за 4 мл.	
Repart® G Deep (1 мл)	1 шприц/1 мл	24 мг/мл	Россия	ООО "ИНГАЛ"	р.4 500	р.4 500			
Repart® G Deep (2 по 1 мл)	2 шприца x 1,0 мл	24 мг/мл	Россия	ООО "ИНГАЛ"	р.7 500	р.3 750			
Repart® G Deep (1 по 2 мл)	1 шприц/2 мл	24 мг/мл	Россия	ООО "ИНГАЛ"	р.7 000	р.3 500	р.11 500		3 мл в пересчете за мл.
Amalain Inconti	2 шприца x 2,0 мл	20 мг/мл	Россия	ООО «МКС – Лаборатория», ООО «СЛС»	р.13 000	р.3 250	только по 2 мл	р.26 000	р.9 750
Reneall Pro Active	2 шприца x 2,0 мл	20 мг/мл	Россия	ООО «МКС – Лаборатория», ООО «СЛС»	р.15 500	р.3 875	только по 2 мл	р.31 000	р.11 625
EsteFiLL Intim	1 шприц/2 мл	24 мг/мл	Россия	ООО "Терлазурра" Россия	р.8 500	р.4 250	только по 2 мл	р.17 000	р.12 750
HYALUFORM® filler Intimo	1 шприц/1 мл	25 мг/мл	Россия	MARTINEX Россия	р.6 500	р.6 500	р.19 500		
Repleri №3	1 шприц/1 мл	24 мг/мл	Россия	ООО "Новонексус" Россия	р.6 000	р.6 000	р.18 000		

G DEEP

Цена за мл. REPART G DEEP

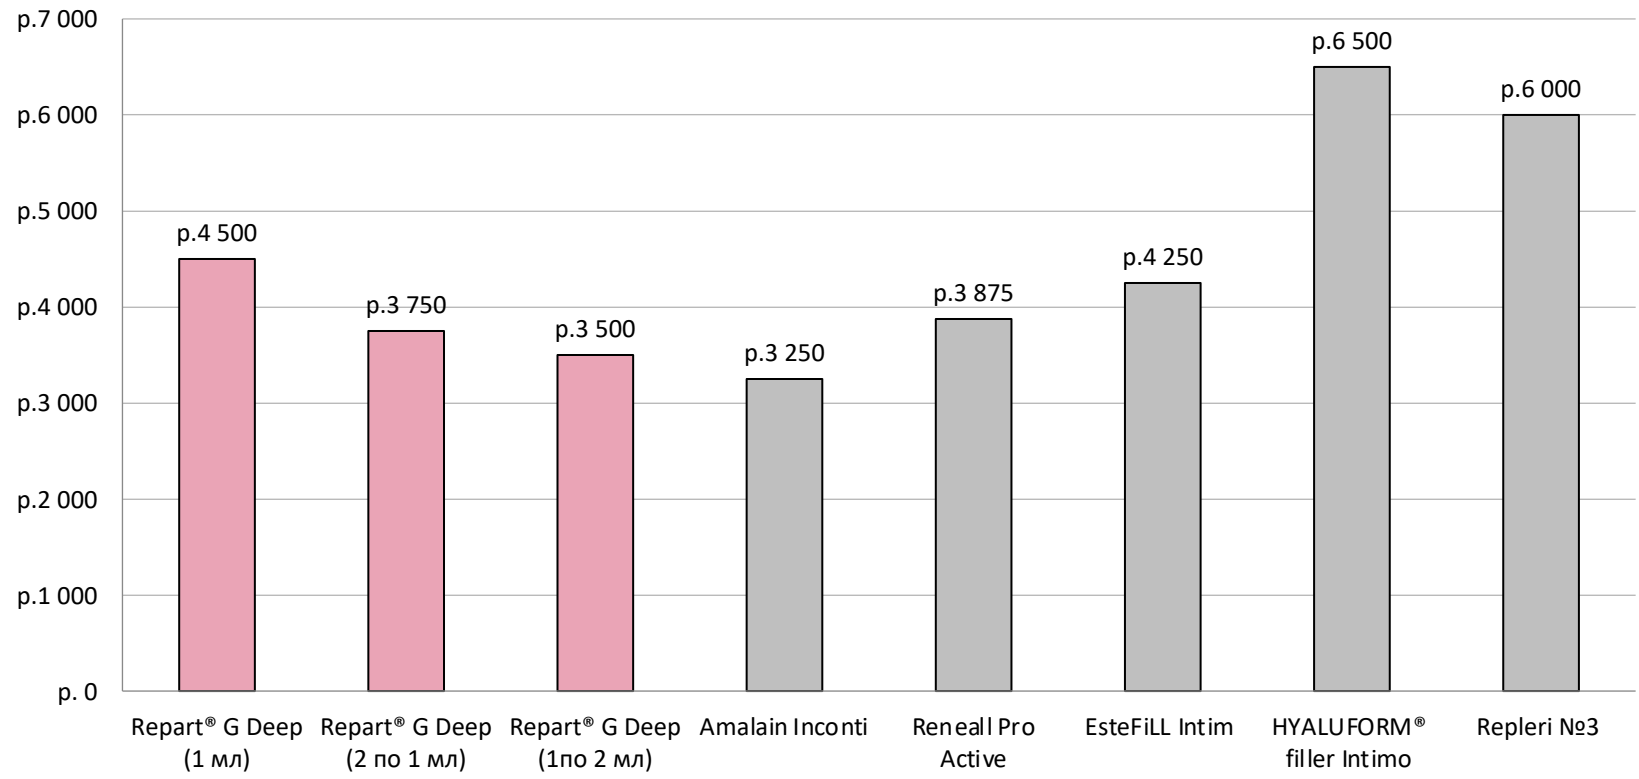


G NORMAL

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ТРЕБУЕТ РАСХОДА ПРЕПАРАТА ОТ 3 ML

Цены за 3 ml рассчитана на основе самой выгодной ценовой комбинации

Цена за 3 мл. относительно параметра "Конкурентное окружение (наименование)"

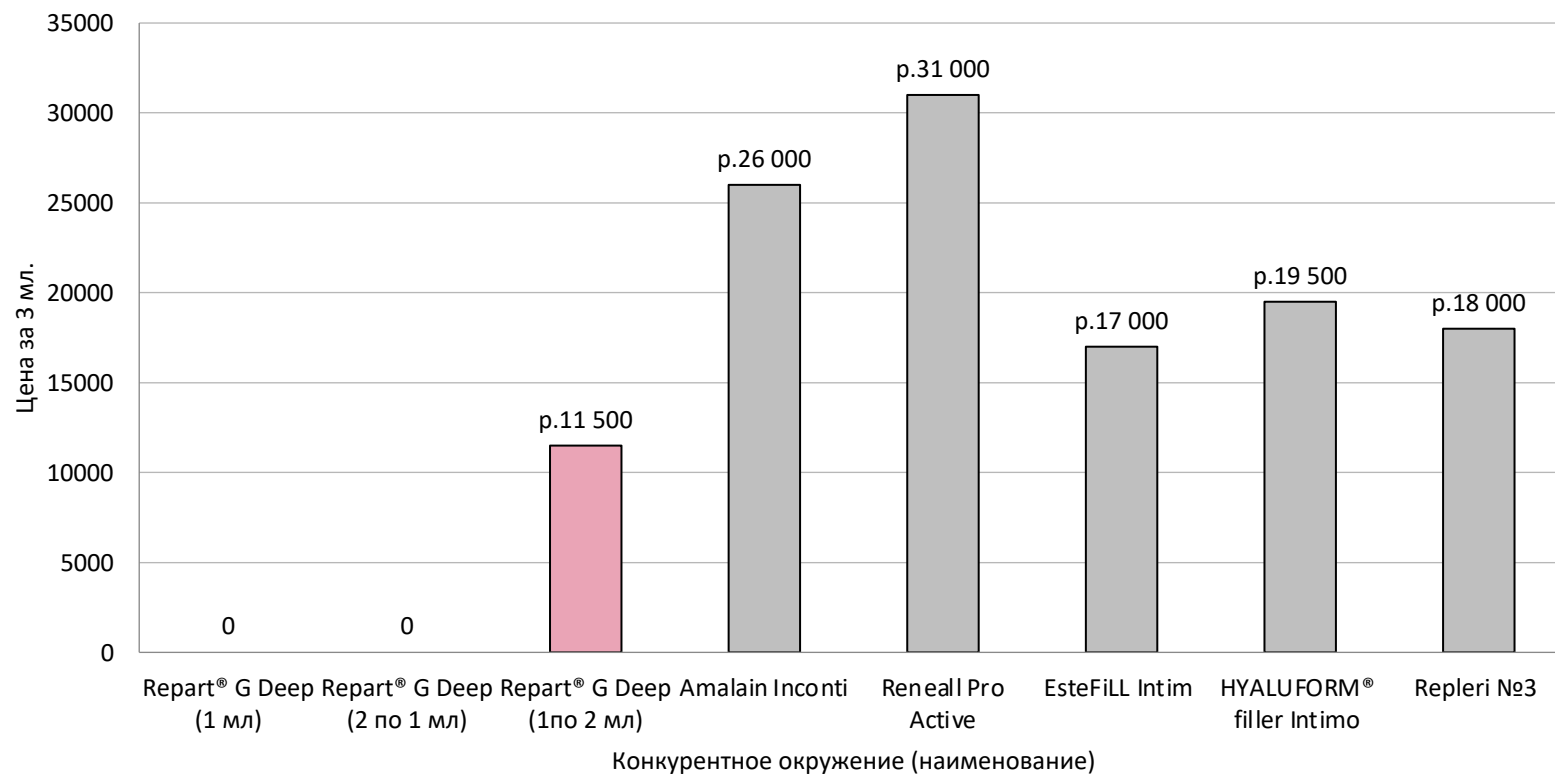

Amalain, Reneall, Estefill только в форме по 2 ml, поэтому цена значительно выше (указана за 4 ml).

В пересчете на 3 ml без учета формы, цена все равно выше, чем у REPART G.

Дополнительные материалы

REPART[®] Ġ



ПРОМОМАТЕРИАЛЫ

REPART®

Контурная
интимная
пластика для
мужчин и женщин

Repart® G –

линия имплантатов мягких тканей для интимной контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты, сшитой современным кросс-линкером PEGDE (полиэтилен гликоль диглицидиловый эфир)



Repart® G Normal состав:

Натрия гиалуронат 20 мг/мл (2,0 %)

Repart® G Deep состав:

Натрия гиалуронат 24 мг/мл (2,4 %)

(ingal) Уникальная разработка научно-производственного комплекса ИНГАЛ



Соответствует стандартам GMP

Имеют высокий профиль безопасности (не содержат BDDE)



Зарегистрированы на территории РФ
Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики "Repart® G" по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

УДОБНЫ В РАБОТЕ

- Обладают улучшенными вязко-эластичными свойствами по сравнению с филлерами ГК, сшитой BDDE
- Имеют высокую подъемную силу и отличные формообразующие свойства
- Имеют широкий спектр зарегистрированных эстетических и терапевтических показаний
- Удобная дозировка: 1,0 мл; 2,0 мл

Repart® G Normal

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики низкой плотности (с низким модулем вязкости G[™]).



Repart® G Deep

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики средней плотности (со средним модулем вязкости G[™]).

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ:

- Деформация больших и малых половых губ (посттравматические, послеоперационные изменения, послеродовые разрывы)
- Дефекты промежности (анатомические, посттравматические, послеоперационные, послеродовые, врожденные)
- Коррекция дефектов уретровезикального сегмента при стрессовом недержании мочи у женщин
- Восполнение объема периуретральной зоны при рецидивирующем посткоитальном цистите у женщин

КОСМЕТИЧЕСКИЕ:

- Асимметрия половых губ
- Дряблость и провисание мягких тканей промежности и стенок влагалища вследствие изменений объема
- Липодистрофия больших половых губ
- Зияние половой щели вследствие недостаточно выраженных половых губ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ:

- Увеличение манты клитора
- Увеличение U точки
- Увеличение зоны G

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ:

- Увеличение продолжительности эректильной функции у мужчин
- Коррекция эстетического дефекта при недержании мочи у мужчин после радикальной простатэктомии или трансуретральной резекции предстательной железы
- Волюмизация при ретроградной эякуляции у мужчин

КОСМЕТИЧЕСКИЕ:

- Увеличение головки полового члена



Предназначены для инъекционного введения в поверхностные слои кожи, подкожной клетчатки, слизистые и подслизистые уrogenитальной области у мужчин и женщин.

(ingal)

+7 (459) 135-09-55 | ingal-cosmetics.ru | info@ingal-med.ru | ingal.cosmetics

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИСТОВКА

ИДС

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО (ПРОЦЕДУРУ ИНЪЕКЦИЙ Имплантата мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G»)

(nqa) Ф.И.О. ПАЦИЕНТА _____
ДАТА РОЖДЕНИЯ: _____
АДРЕС: _____

Дано свое информированное добровольное согласие в соответствии с требованиями статей 13, 20, 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2010 года № 323-ФЗ (далее – «ФЗ») основываясь на информации (впоследствии) предоставленной мне согласием на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане имеют информированное добровольное согласие, при выборе врача и медицинской организации, для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный Приказом Минздрава Российской Федерации от 23.04.2012 № 350н, а также на выполнении мне процедур введения в мягкие ткани гиалуроновой кислоты на основе гиалуроновой кислоты с торговым названием:

Repart® G Normal Repart® G Deep

В ОБЪЕМЕ _____ МА, В ОБЛАСТИ: _____ создать авторскую запись
ВРАЧУ: _____ (ФИО ВРАЧА)

В доступной для меня форме мне сообщена, подробно разъяснена врачом и понята следующая информация: цели, методика выполнения процедуры, показания к медицинскому вмешательству, вид процедуры, варианты, возможные осложнения и побочные эффекты, используемые медикаменты/медицинские изделия, условия, особенности проведения медицинского вмешательства и процедуры, все риски, связанные с медицинским вмешательством, торговое название препарата. Мне известно, что процедура представляет собой неинвазивное введение препарата (геля) с содержанием гиалуроновой кислоты в мягкие ткани определенной области. Результаты RePart® G проявляются с целью эстетической коррекции в ретроабдоминальной и мужской зоне.

Показаниями к применению инъекций геля имплантата (Филлера) на основе гиалуроновой кислоты являются:

- Деформации больших и малых половых губ (постравматические, постоперационные изменения, послеродовые рубцы);
- Асимметрия половых губ;
- Дефекты пронижности (анатомические, постравматические, постоперационные, послеродовые, врожденные);
- Значимые половые щели вследствие недостаточности внешних половых губ;
- Дряблость и провисание мягких тканей промежности и слезки влагалища вследствие изменений объема;
- Алопеция/облысение больших половых губ;
- Увеличение зоны G;
- Увеличение интимной клиторы;
- Увеличение U трети;
- Увеличение половой членовой;
- Увеличение продолжительности эрекции/длительной функции у мужчин;
- Коррекция дефектов уретровезикулярного сегмента при стрессовом недержании мочи у мужчин;
- Восполнение объема ретроабдоминальной зоны при рецидивирующей постоперационной целлюлите у мужчин;
- Восполнение при ретроградной эякуляции у мужчин;
- Коррекция эстетического дефекта при недержании мочи у мужчин после радикальной простатэктомии или трансуретральной резекции предстательной железы.

Медицинское вмешательство проводится в соответствии с Приказом Минздрава Российской Федерации от 28.04.2012 № 350н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «косметология» в аспетических условиях, стандартами одобреными инструментами/медицинскими изделиями с соблюдением всех мер дезинфекции.

В соответствии с/противопоказаниями врачом в следующих обстоятельствах, связанных с введением геля (раствора) на основе гиалуроновой кислоты:

1. Срок эстетического действия препарата составляет до 12 месяцев, после чего может возникнуть необходимость повторных инъекций.
2. Действие препарата наступит сразу после проведенной инъекции. Физиологическое действие геля-имплантата сохранится в течение всего времени нахождения геля в тканях организма человека.
3. В редких случаях немедленного или задержанного после инъекции, могут наступить следующие реакции:
 - ✓ Отек, боль, зуд, покраснение/зуд, гиперемия. Большинство инъекций введения, которые обычно купируются в течение первых трех суток после инъекции.
 - ✓ Возможно формирование гематом в месте инъекции.
 - ✓ Изредка исключенной является некроз в месте введения имплантата, инфицирование, формирование гранулем, фиброзной капсулы, аллергические реакции на компоненты медицинского изделия.
 - ✓ В редких случаях в первые сутки после процедуры возможно развитие острой задержки мочи, вследствие высокой гидрофильности гиалуронового геля, требующей катетеризации.
 - ✓ Возможно развитие асимметрии мягких тканей в области инъекции. Данный эффект носит кратковременный характер и может быть связан с местной реакцией, которая самостоятельно в некоторых случаях для устранения данного эффекта требует дополнительного введения дополнительного геля-имплантата.
 - ✓ Возможно отсутствие ожидаемого эстетического или терапевтического эффекта после проведенной процедуры.
 - ✓ Возможно проведение повторной процедуры/повторной процедуры, количество которых зависит от индивидуальной реакции организма на процедуру.

Противопоказаниями к инъекциям геля-имплантата (Филлера) на основе гиалуроновой кислоты являются:

- Повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия.
- Беременность.
- Терапия антибиотиками.
- Возраст менее 18 лет.
- Острые воспалительные заболевания или хронические кожные заболевания в зоне проведения инъекций.
- Инфекционные заболевания.
- Наличие аутоиммунных заболеваний или проводимая химиотерапия или лучевой терапии.
- Наличие аутоиммунных заболеваний или проводимое курсом аутоиммунной терапии.
- Генерализованный сыпь, прием антикоагулянтов и препаратов, снижающих свертываемость крови.
- Заболевания урогенитального тракта в острой фазе.
- Нарушения свертываемости кожного гущей.
- Наличие иных инъекций, в т.ч. постовыхых и от природы гиалуроновой кислоты) в местах предполагаемых инъекций гиалуроновой кислоты в зонах ретроабдоминальной коррекции.

Рекомендации, ограничения и уход на время после процедуры:

- Обработанные область инъекции могут зудеть, могут появиться или покраснеть до тех пор, пока полностью не закончится восстановительный период после инъекции.
- После проведения процедуры следует строго воздерживаться от половых актов в течение 5-7 дней.
- Рекомендуется избегать посещения бани, сауны, активной физической нагрузки в течение недели после проведения процедуры.
- Повторить процедуру можно по мере сниженной эффекта.
- Сразу 3 недели возможна дополнительная коррекция.
- Исключить применение инъекций процедур и инъекций в зоне инъекций без согласования с лечащим врачом.


Я сообщил(а) врачу все известные мне сведения о нижеуказанном:

- Хронических и острых заболеваниях, перенесенных травмах, операциях.
- Аллергических реакциях, в том числе на медицинские препараты.
- Лечение, процедурах и манипуляциях, выполняемых в течение предыдущего года и осуществляемых в настоящее время в других медицинских организациях.
- Любимых препаратах, применяемых в настоящее время, в т.ч. антибиотиками и антигематоцитами.
- Иными инъекциями (в т.ч. постовыхых и от природы гиалуроновой кислоты) в местах предполагаемых инъекций Филлера.


Я обязуюсь сообщить своему лечащему врачу о любых побочных эффектах, возникших после процедуры.

МОКАПЫ УПАКОВОК



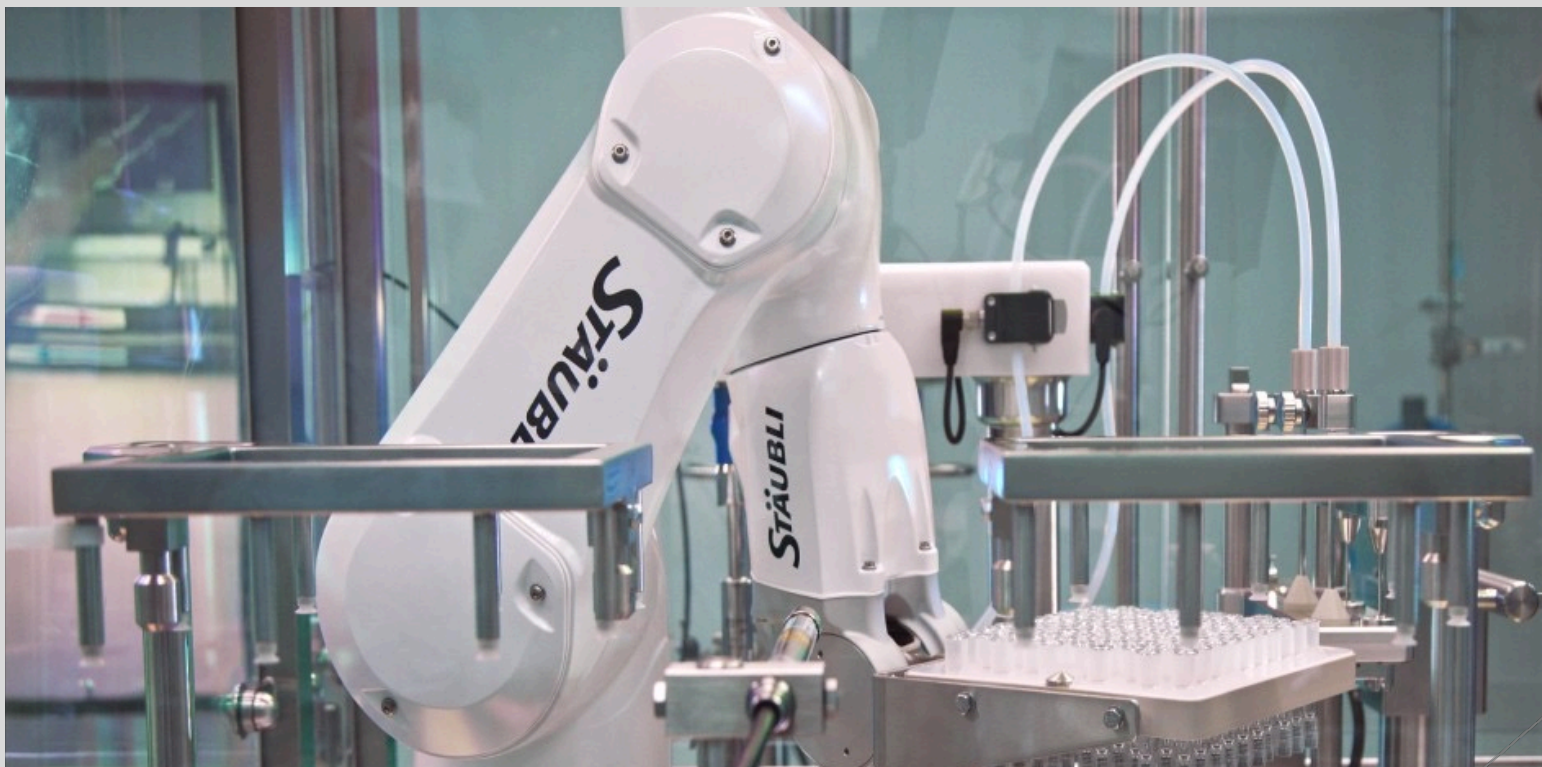

О КОМПАНИИ

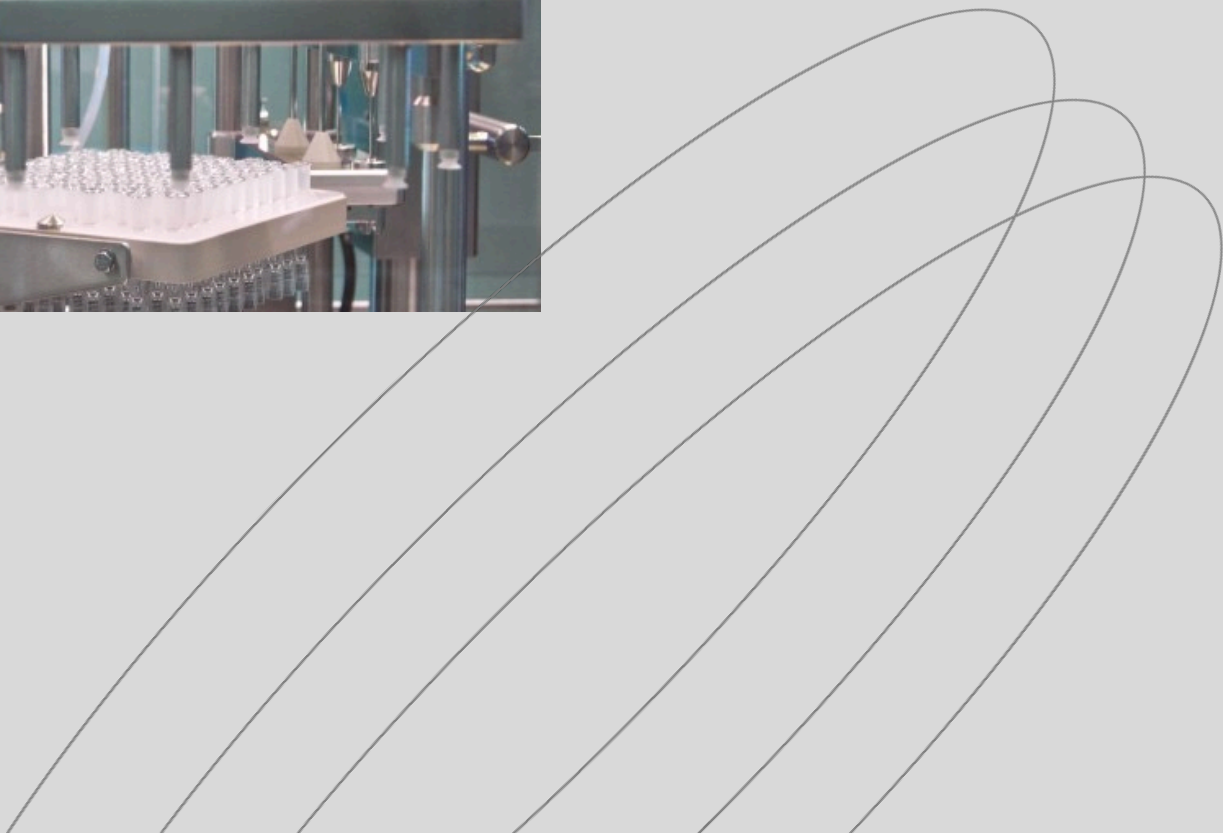

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ INGAL

Компания INGAL – ведущий российский производитель медицинских изделий и лекарственных средств для применения в ревматологии, ортопедии, эстетической и других областях медицины.

Научно – производственный комплекс организован в соответствии со стандартами GMP и оснащен самым современным роботизированным оборудованием.



R&D ЛАБОРАТОРИЯ

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ:
Собственная научная лаборатория
Центр разработок, в т.ч. R&D центр,
где разрабатываются
производственные ноу-хау.

Г.О. Павловская Слобода
(Московская область)

площадь более

4 ТЫС.КВ.М.



Ключевые преимущества компании INGAL



Российская фармацевтическая компания

Производство лицензировано для осуществления фармацевтической деятельности, регулируется стандартами **ISO и EU GMP**.

Оснащено самым современным роботизированным оборудованием известных европейских компаний Zellwag, Groninger, IMA и Systec.




Разработано для европейских женщин и мужчин

На базе **R&D центра и собственной научной лаборатории** разрабатываются производственные ноу-хау. Компанией зарегистрировано 4 медицинских изделия, которые не имеют аналогов на рынке.



Самые дорогие субстанции

Субстанции мировых лидеров – концерна **BLOOMAGE и Evonic**. Одобрены FDA, в РФ и странах ЕС и используются в производстве самых современных препаратов на основе ГК и др. биоразлагаемых полимеров.



Уникальные технологии

Spider Thread

Собственная запатентованная технология позволяет создавать препараты гиалуроновой кислоты с **улучшенными характеристиками**. Именно процесс превращения сухой субстанции BLOOMAGE в готовую субстанцию является **ключевым фактором отвечающим за качество готового продукта**.

Метод двойного эмульгирования Собственная технология эмульгирования и двойной лиофилизации производства для препаратов из полимолочной кислоты.



Регистрационная документация

Наличие регистрационных удостоверений для всех медицинских изделий




Клинические исследования, накопленный опыт о применении препаратов

Накопленная база отзывов и клинически зарегистрированных эффектов



Цена - Качество - Результат

Выгодная цена для косметолога и доступная за процедуру для клиента. Контроль качества, бесперебойные поставки, ориентированное на рынок ценообразование.



Выбор косметолога

Оптимальные объемы и формы упаковки, позволяющие эффективно выстроить рабочие процессы. Оперативная обратная связь с заводом-производителем.